

Инструкция Кровать

ellipse™ Basic



1. Инструкция по безопасности

1.1 Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию.

1.2 Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоем.

1.3 Производитель не несет ответственность за неправильную установку изделия.

1.4 Не используйте изделие, если оно повреждено.

1.5 Не следует использовать изделие на неровной поверхности.

1.6 Периодически проверяйте крепежные узлы.


2. Рекомендации по эксплуатации и уходу

2.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.


2.2 Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.

2.3 Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.


Перечень Кровать Basic 1200

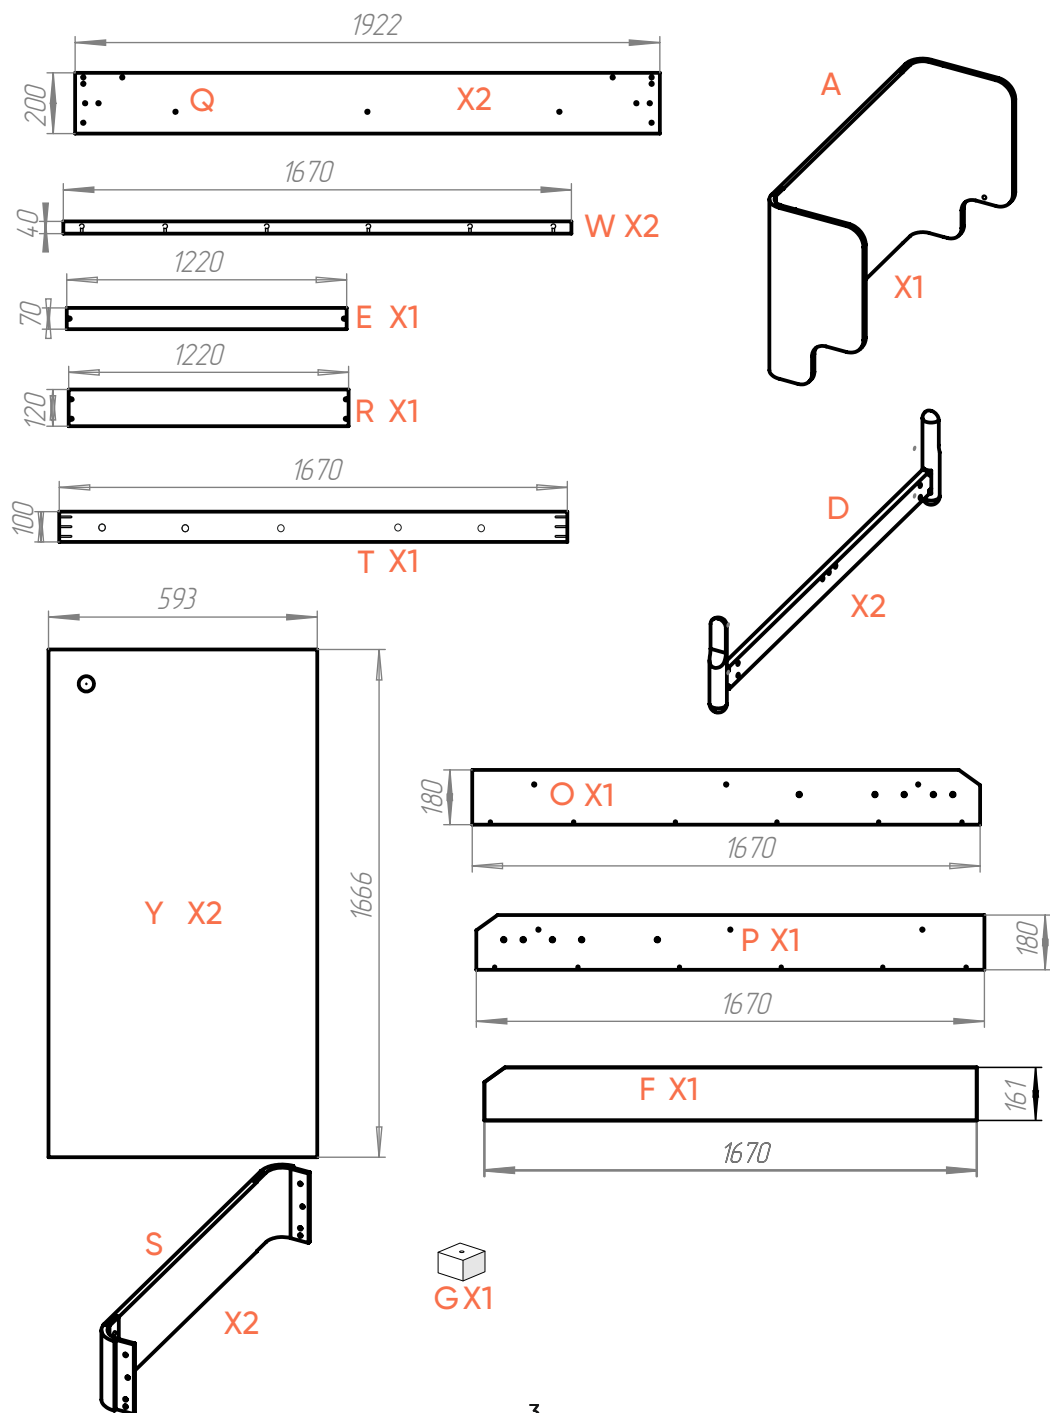


Перечень Кровать Basic 1400

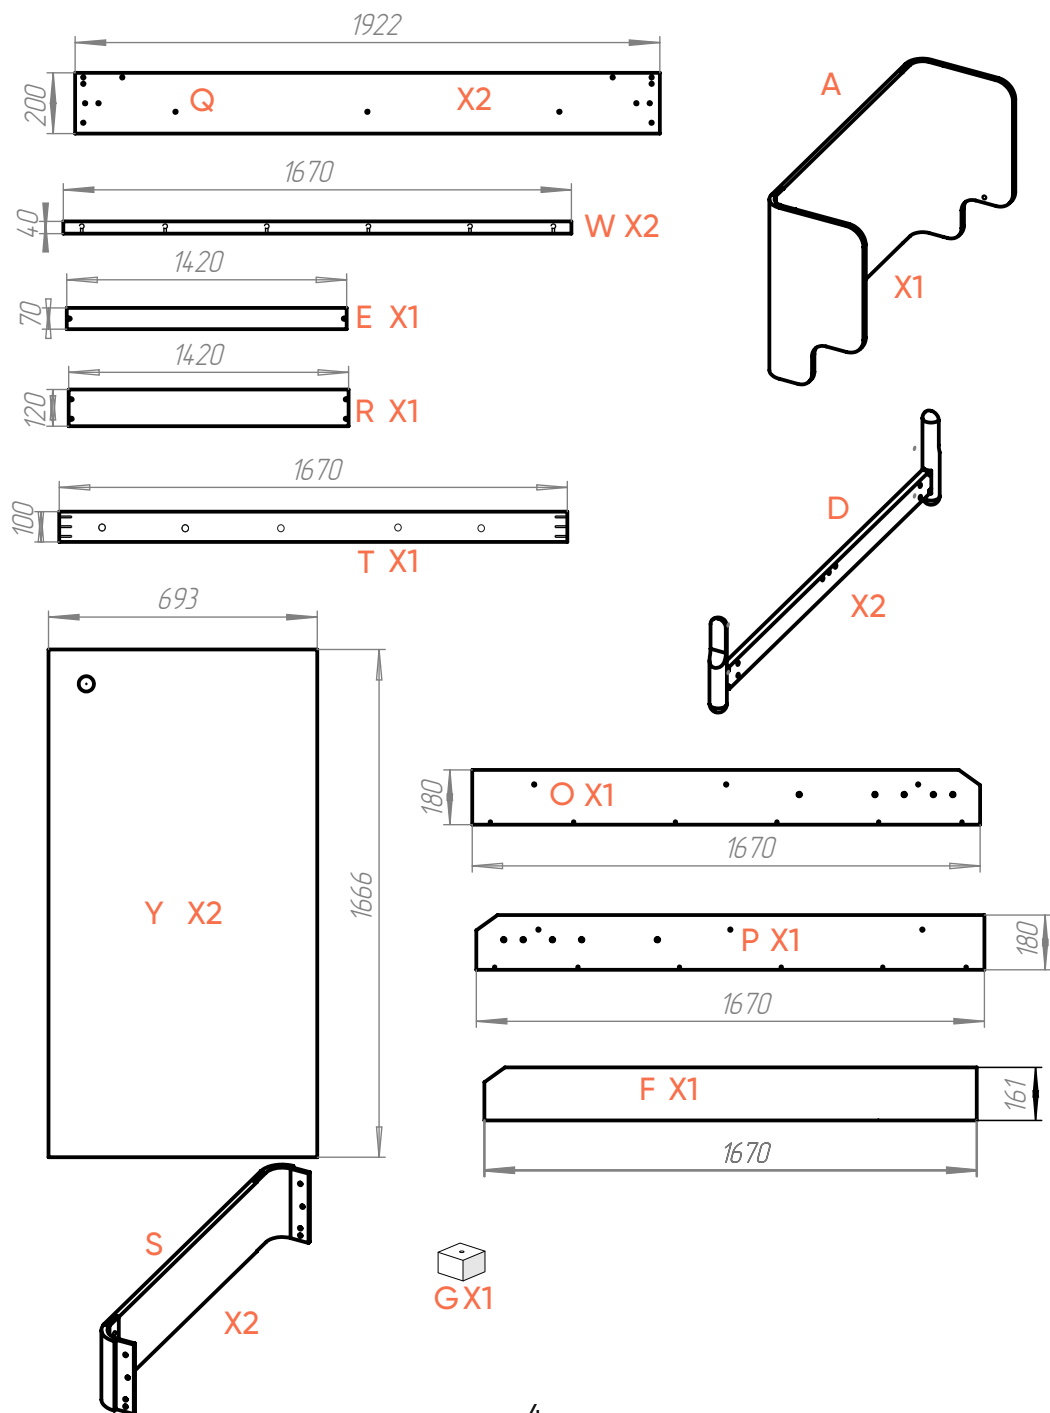


Перечень Кровать Basic 1600

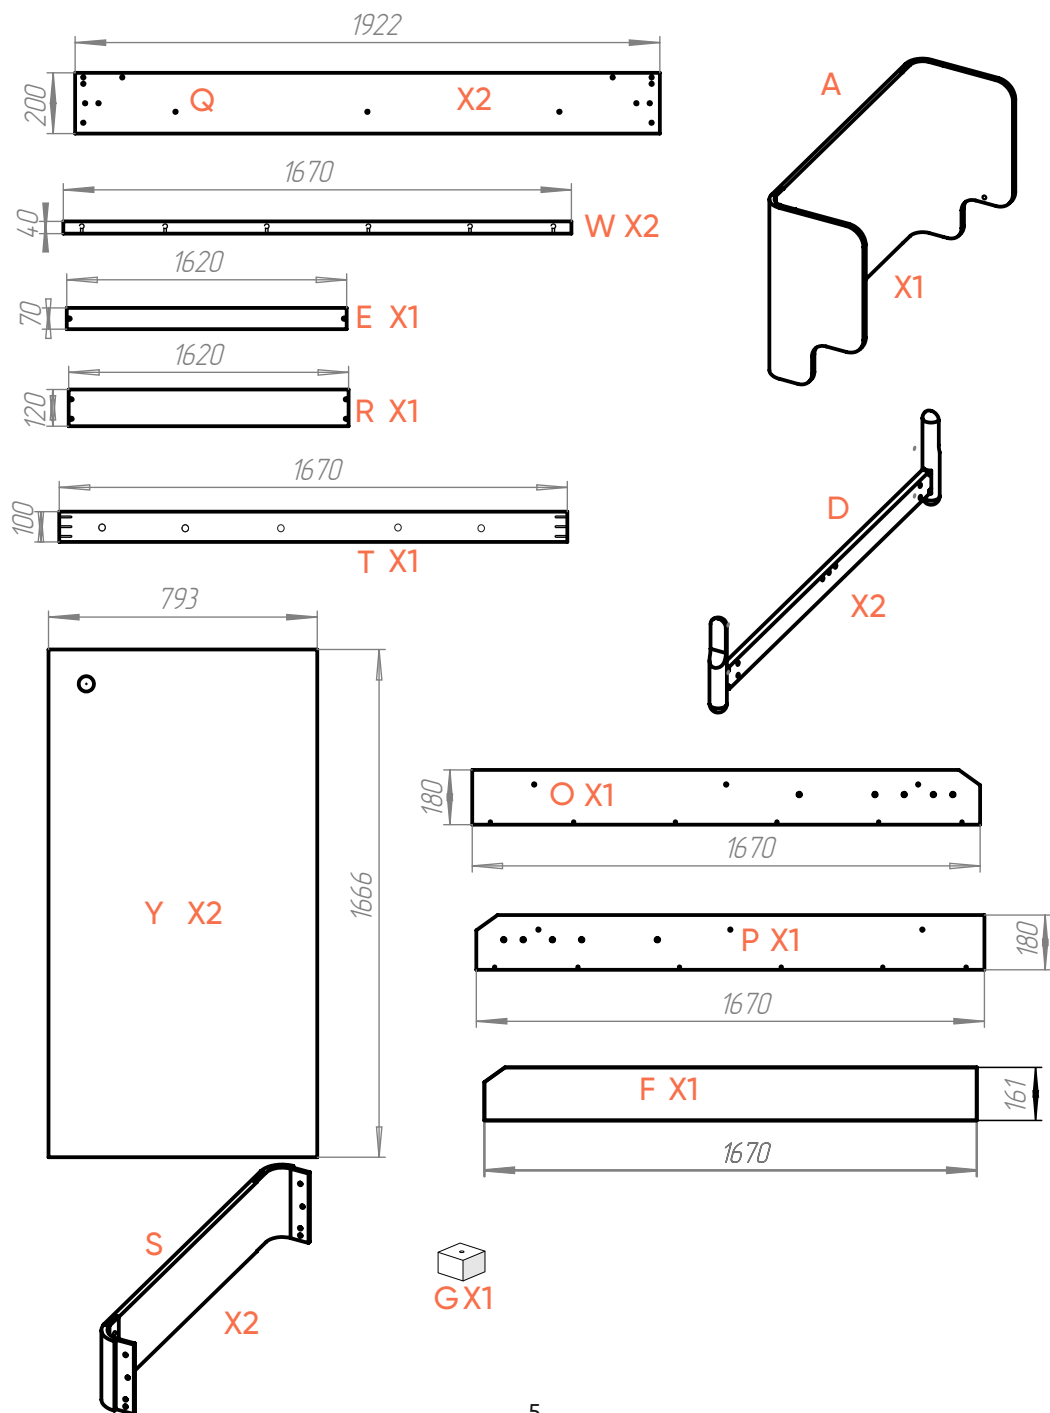

Перечень Кровать Basic 1800

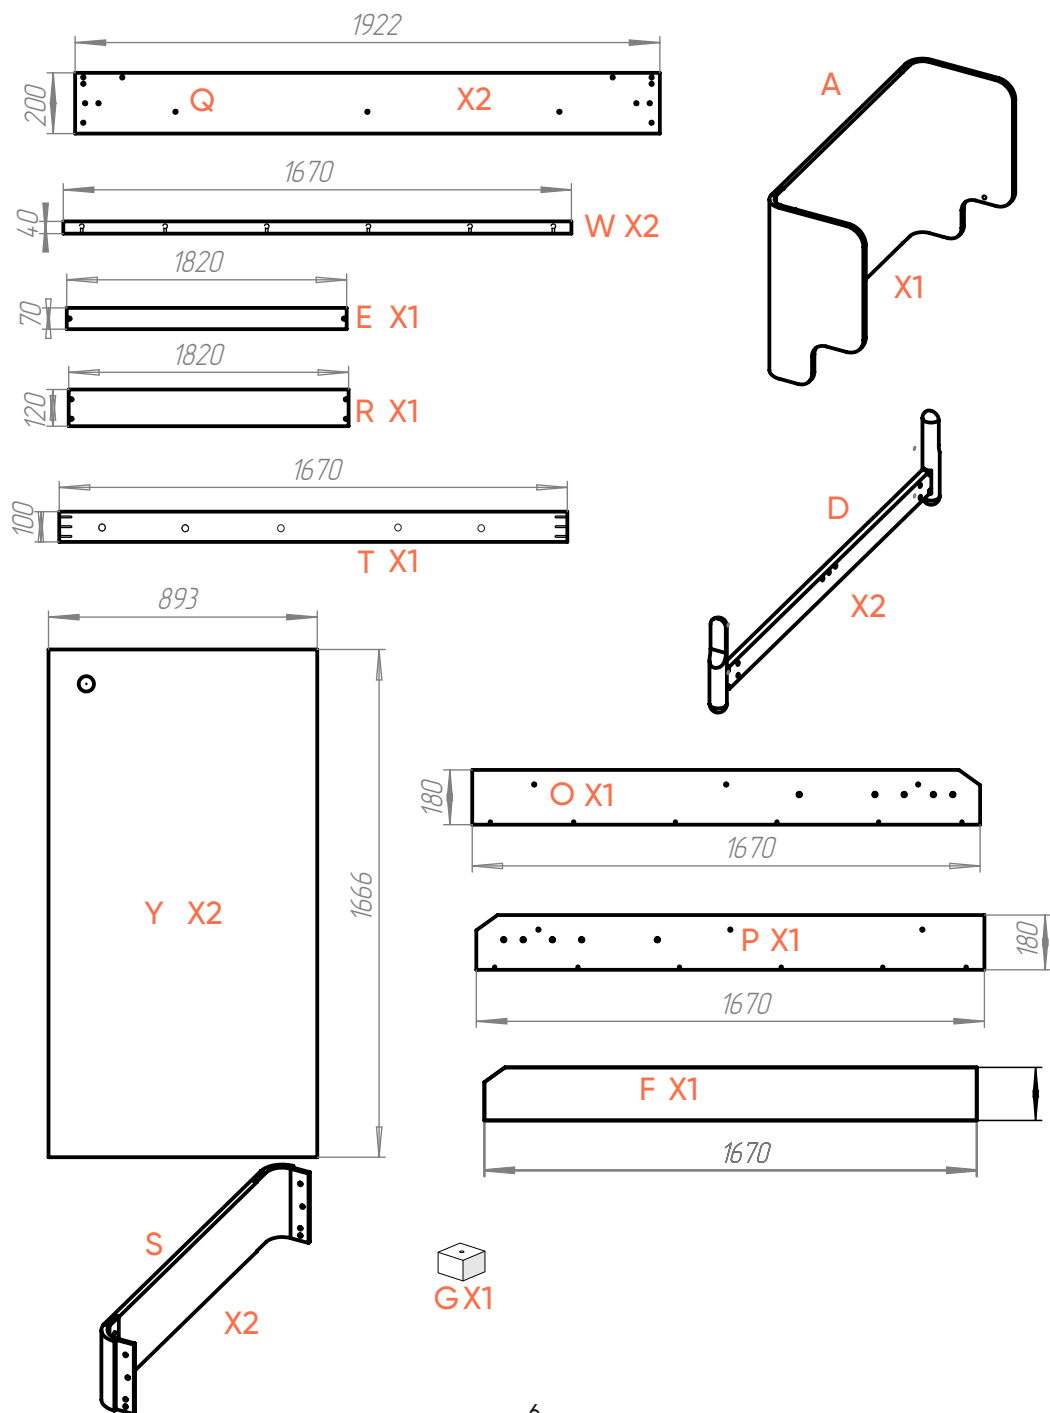




x29 x12



x12



x12




x1




x11




x12




x2




x4

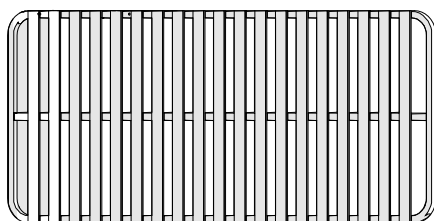

x1



Комплект




x2




x2

1

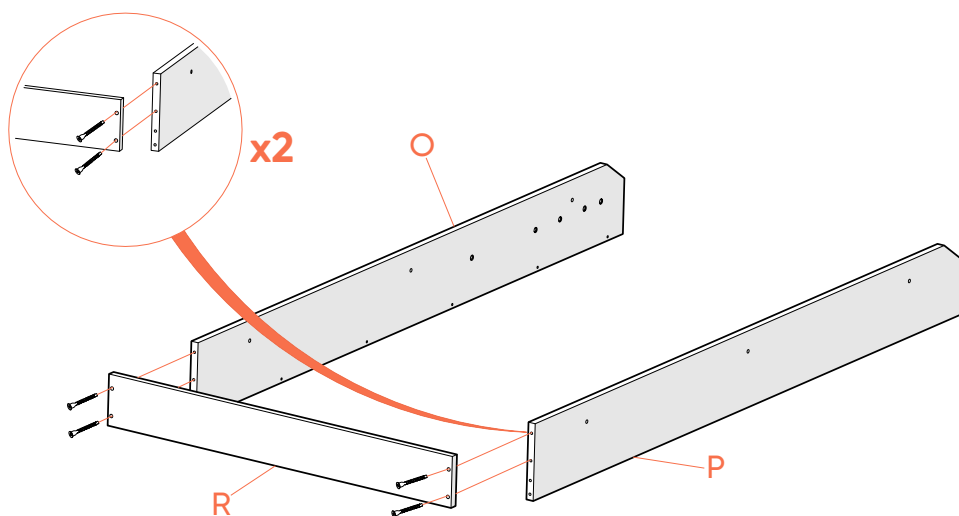


x4

2

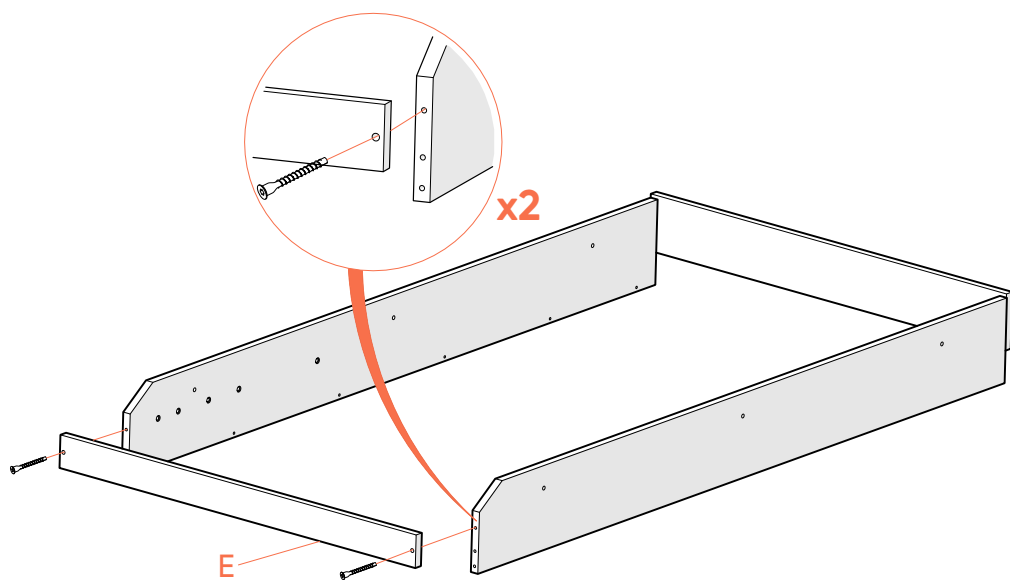

x2

3

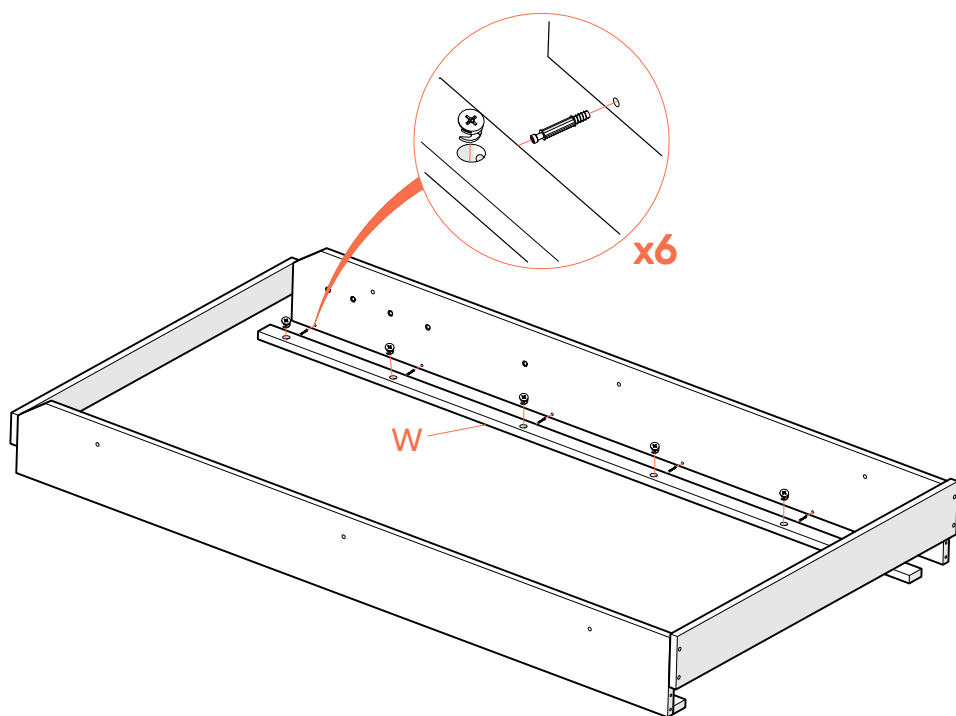


x6



x6

4

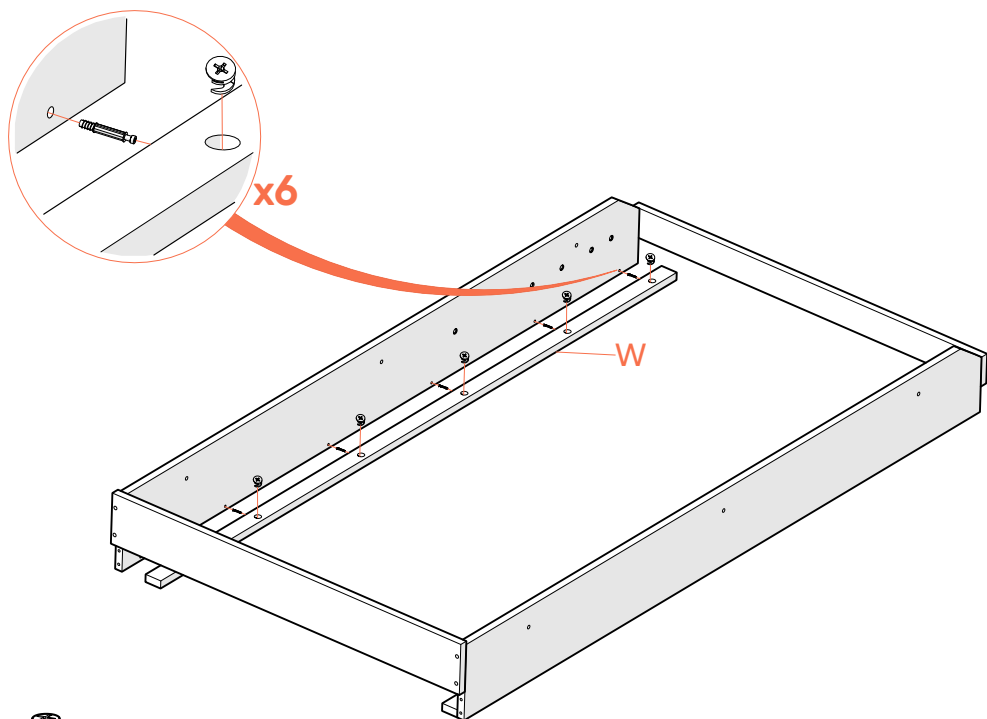

x6




x6


5



x4


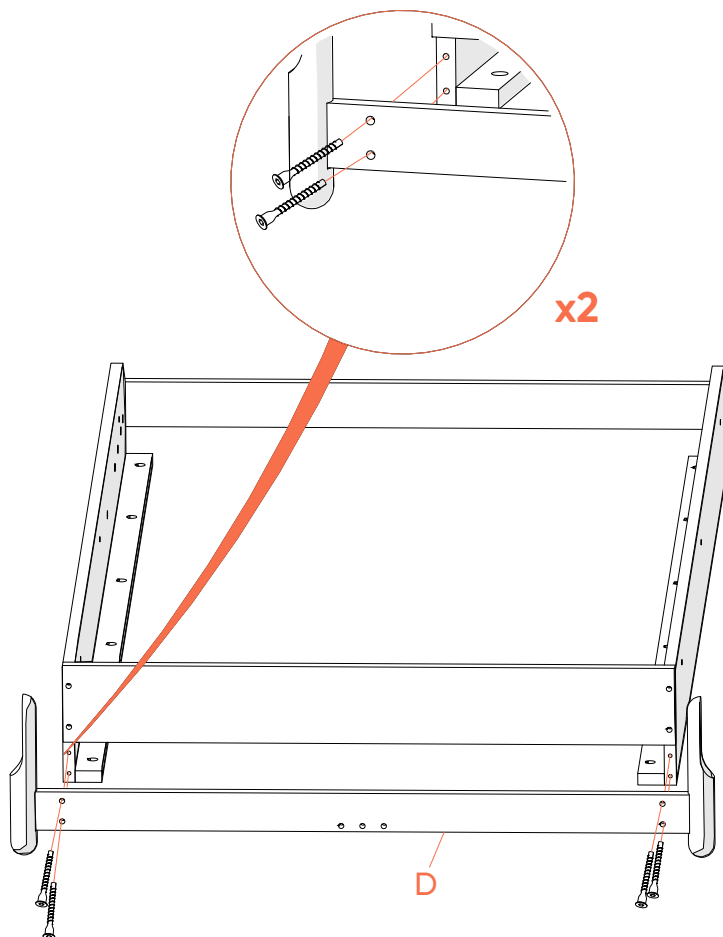


6

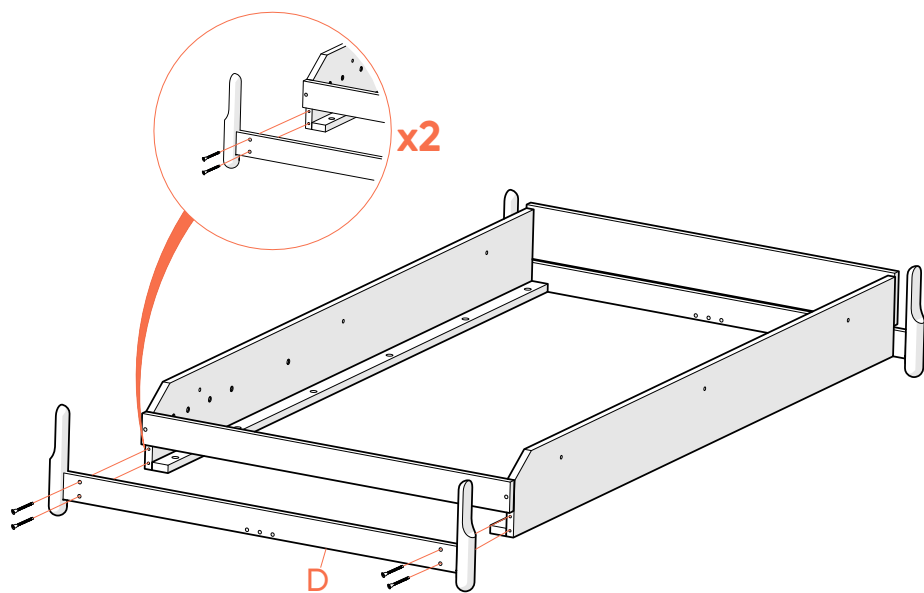

x4

7

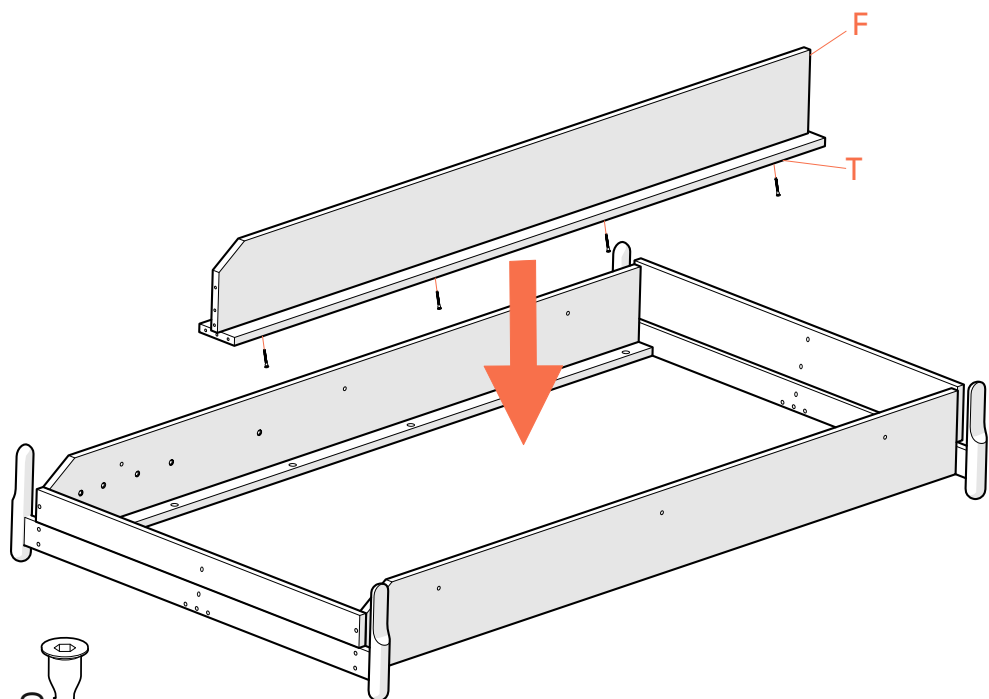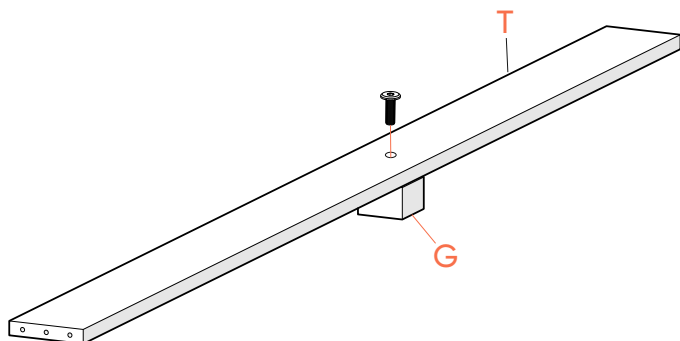


x4




x1

8

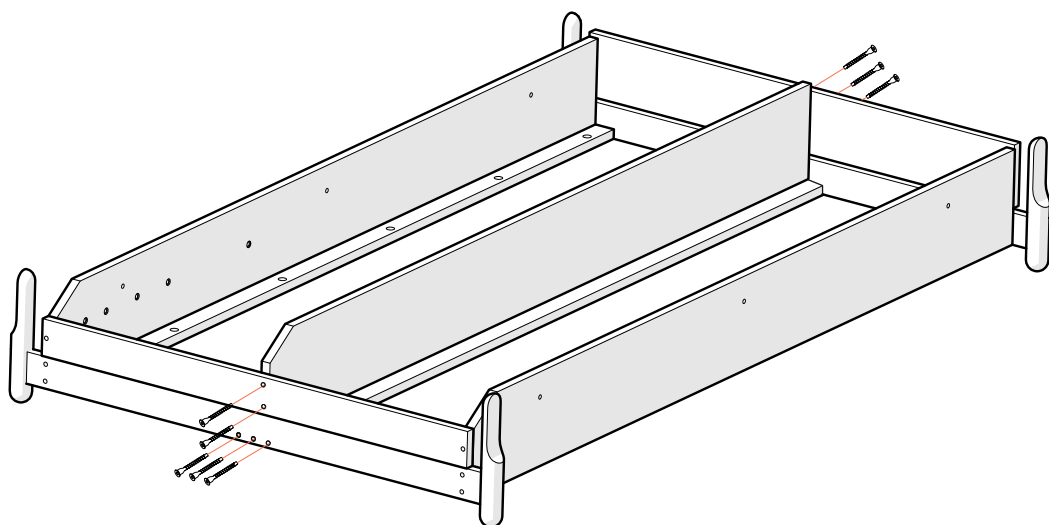


x11

9

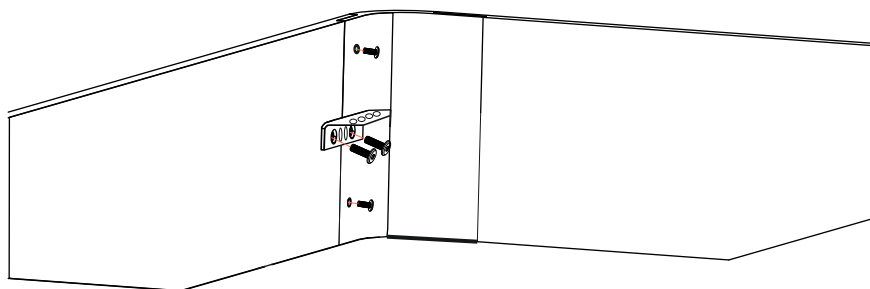


x4




x2

10

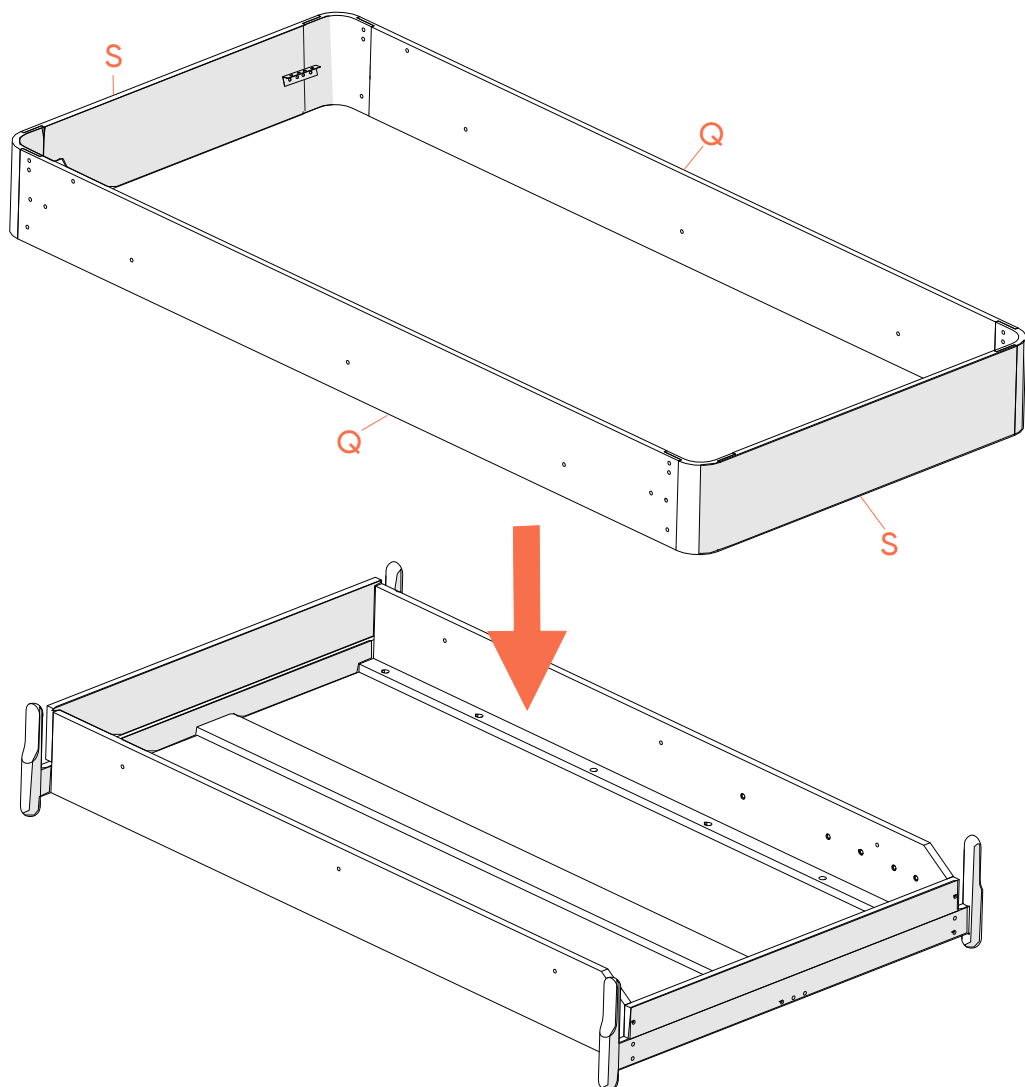


11

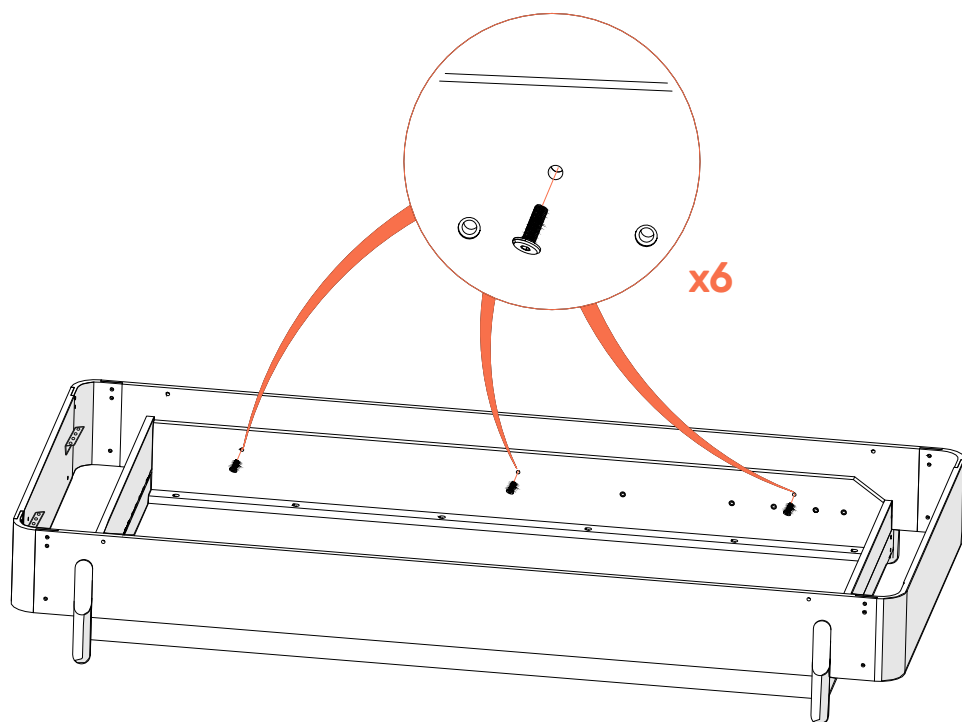


x6

12

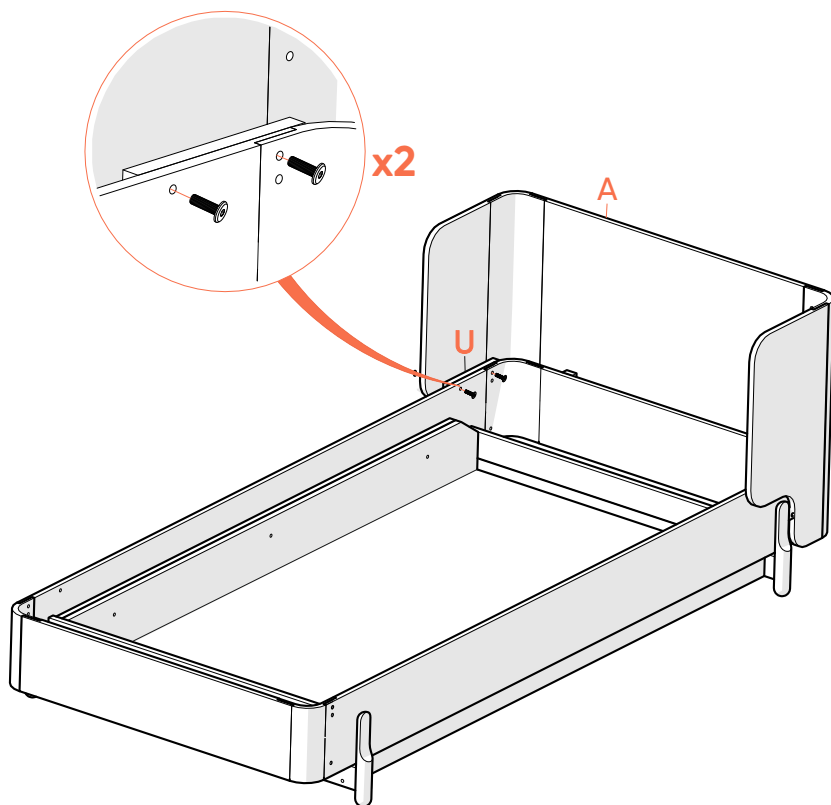


x4

13

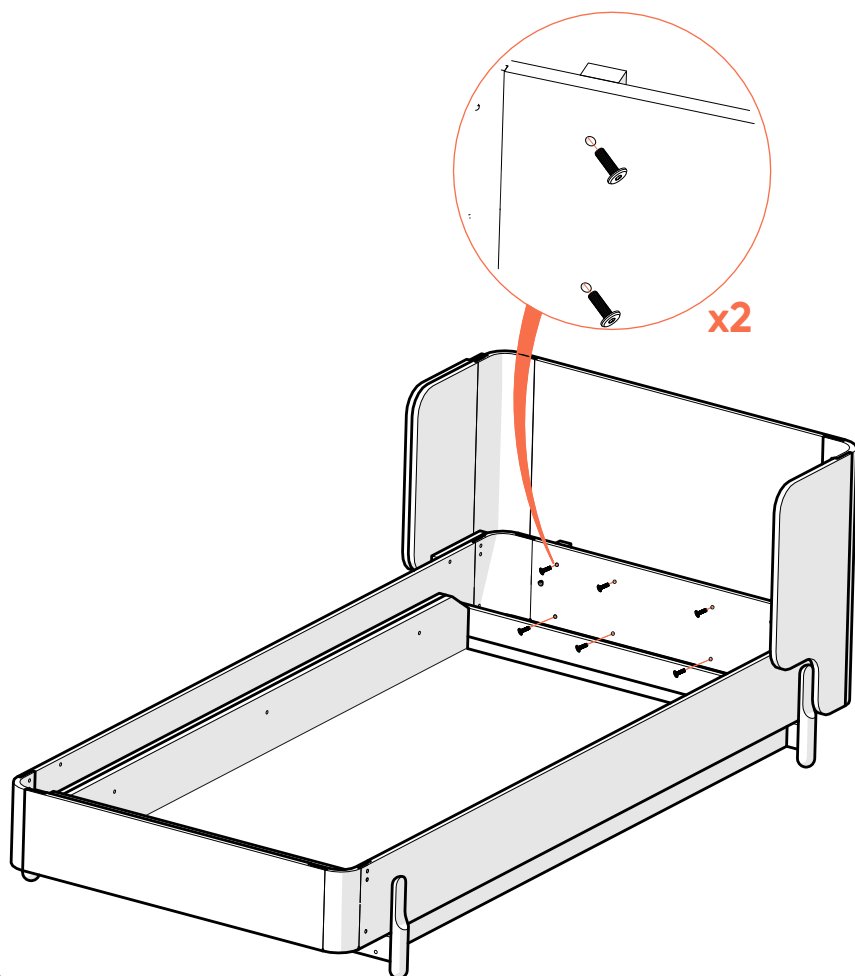


x8

14

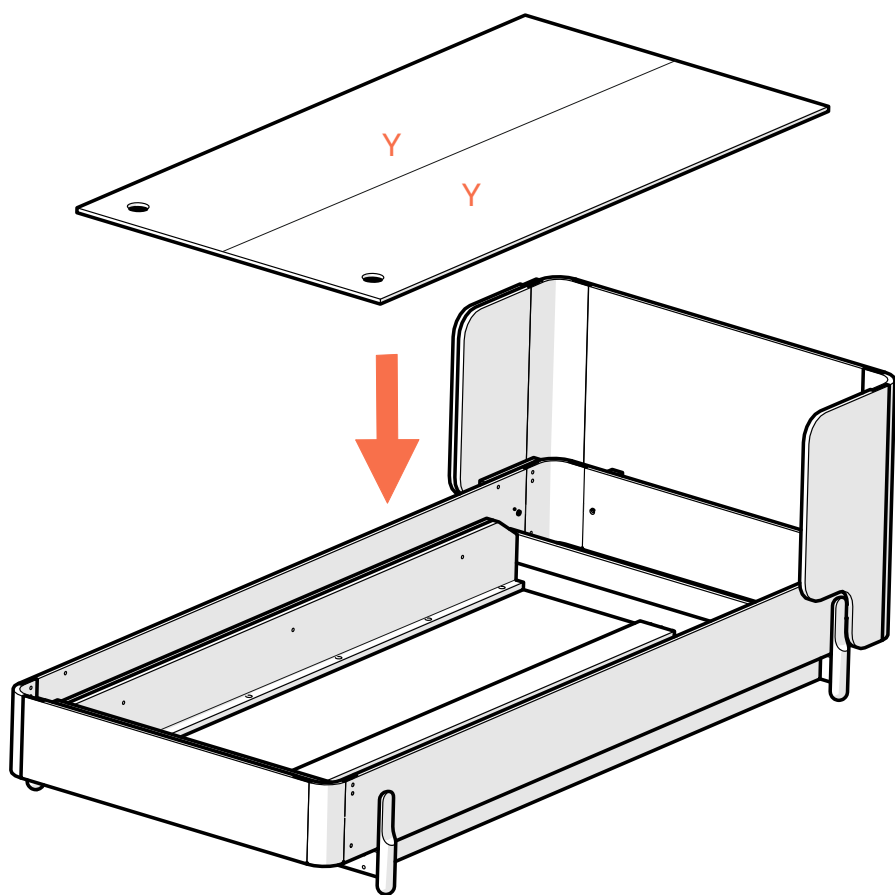


15


Внимание! уголок устанавливается во внешнюю сторону

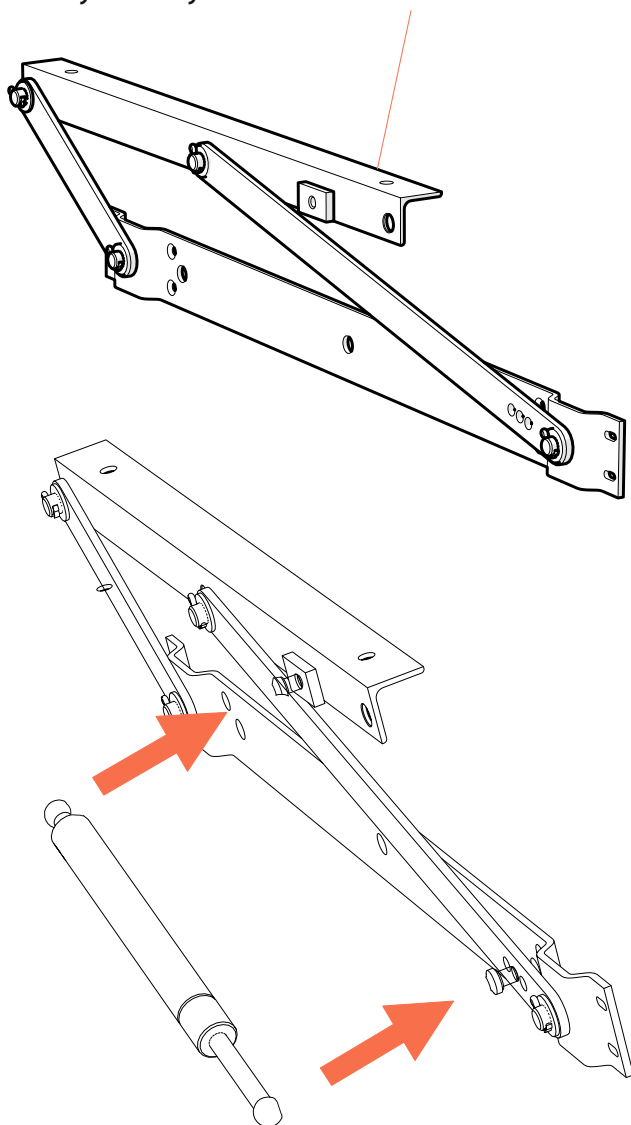


16

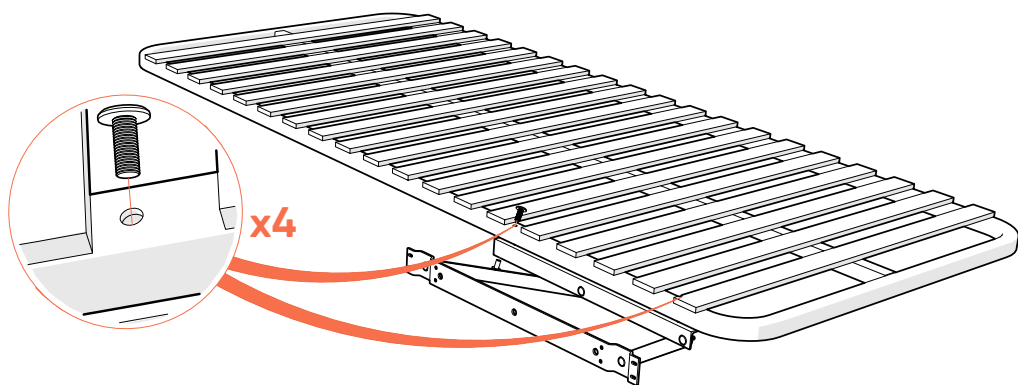

M6x30




x4



x4

17

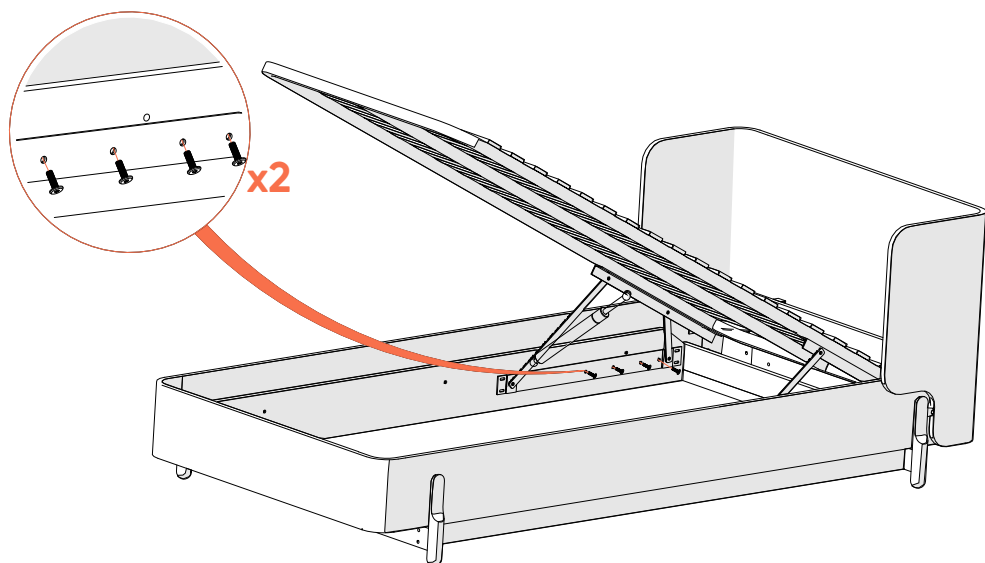

x8

Установка производится на открытом основании
Для установки требуется 2 человека